SI	Potencia [W]	Frecuencia [Hz]
LABORATORIO DE REFERENCIA	CENAM Incertidumbre Potencia RF: 20 mW/W Factor de calibración: 0.017 - 0.019 Coeficiente de reflexión, S11: 0.0035 - 0.0159	CENAMEP AIP Laboratorio S0 UTC(CNMP) 5E-14 Hz/Hz en 5 días
PATRÓN DE REFERENCIA		Escala de tiempo UTC(CNMP) formada por el conjunto de Patrones Atómicos de Tiempo y Frecuencia del Laboratorio S0. [Documento de trazabilidad mensual]
PATRÓNES DE MEDIDA DE TRABAJO	Medidor de potencia RF CMP-F0-101, CMP-F0-110 Sensor de potencia CMP-F0-102, CMP-F0-103, CMP-F0-109 Incertidumbre 67 mW/W [Periodo de calibración anual]	Contador de microondas Generador de radiofrecuencias CMP-F0-101, CMP-F0-104 Incertidumbre 8E-8 Hz/Hz [Periodo de verificación semestral]
SERVICIOS PRESTADOS (imágenes de equipos calibrados)	 Generadores de señales de RF	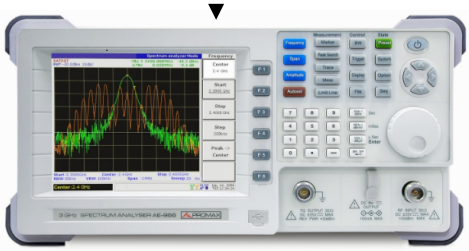 Medidores de señales de RF

[Calibración en frecuencia y potencia de medidores y generadores de señal de radiofrecuencias]

Alcance
Frecuencia: 50 MHz hasta 20 GHz
Potencia: 100 µW hasta 3 W